



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
(РОСЗДРАВНАДЗОР)

**РЕГИСТРАЦИОННОЕ УДОСТОВЕРЕНИЕ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 08 июня 2021 года

№ РЗН 2021/14526

На медицинское изделие

Шкаф медицинский металлический по ТУ 32.50.30-011-14513602-2020

Настоящее регистрационное удостоверение выдано

Общество с ограниченной ответственностью "ТК ПРОФИ-М"

(ООО "ТК ПРОФИ-М"), Россия,

624071, Свердловская область, г. Среднеуральск, ул. Вторая, д. 1

Производитель

Общество с ограниченной ответственностью "ТК ПРОФИ-М"

(ООО "ТК ПРОФИ-М"), Россия,

624071, Свердловская область, г. Среднеуральск, ул. Вторая, д. 1

Место производства медицинского изделия

ООО "ТК ПРОФИ-М", Россия, 692407, Свердловская область,

г. Среднеуральск, ул. Вторая, д. 1

Номер регистрационного досье № РД-38946/101233 от 22.01.2021


Класс потенциального риска применения медицинского изделия 1

Код Общероссийского классификатора продукции по видам экономической
деятельности **32.50.30.110**

Настоящее регистрационное удостоверение имеет приложение на 8 листах

приказом Росздравнадзора от 08 июня 2021 года № 5300
допущено к обращению на территории Российской Федерации.

**Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения**

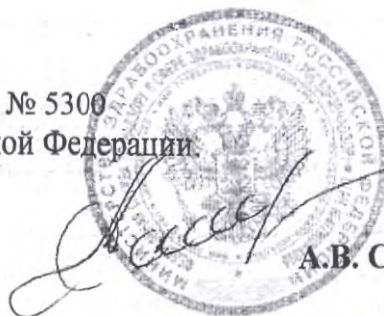

А.В. Самойлова

0057456

ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ

от 08 июня 2021 года

№ РЗН 2021/14526

Лист 1

На медицинское изделие

Шкаф медицинский металлический по ТУ 32.50.30-011-14513602-2020,

варианты исполнения:

1. LASER-PROF МД 1 1650/SS, в составе:

- корпус шкафа - 1 шт.;
- дверца шкафа стальная - не более 2 шт. (при необходимости);
- полка шкафа стальная - не более 4 шт. (при необходимости);
- ручка шкафа - не более 2 шт. (при необходимости);
- замок шкафа - не более 2 шт. (при необходимости);
- руководство по эксплуатации.

2. LASER-PROF МД 1 1650/SG, в составе:

- корпус шкафа - 1 шт.;
- дверца шкафа стальная - не более 2 шт. (при необходимости);
- дверца шкафа стеклянная - не более 2 шт. (при необходимости);
- полка шкафа стальная - не более 4 шт. (при необходимости);
- полка шкафа стеклянная - не более 4 шт. (при необходимости);
- комплект петель для стекла - не более 2 шт. (при необходимости);
- ручка шкафа - не более 1 шт. (при необходимости);
- замок шкафа - не более 1 шт. (при необходимости);
- руководство по эксплуатации.

3. LASER-PROF МД 1 1657/SS, в составе:


- корпус шкафа - 1 шт.;
- дверца шкафа стальная - не более 2 шт. (при необходимости);
- полка шкафа стальная - не более 4 шт. (при необходимости);
- ручка шкафа - не более 2 шт. (при необходимости);
- замок шкафа - не более 2 шт. (при необходимости);
- руководство по эксплуатации.

4. LASER-PROF МД 1 1657/SG, в составе:

- корпус шкафа - 1 шт.;
- дверца шкафа стальная - не более 2 шт. (при необходимости);
- дверца шкафа стеклянная - не более 2 шт. (при необходимости);
- полка шкафа стальная - не более 4 шт. (при необходимости);
- полка шкафа стеклянная - не более 4 шт. (при необходимости);
- комплект петель для стекла - не более 2 шт. (при необходимости);
- ручка шкафа - не более 1 шт. (при необходимости);
- замок шкафа - не более 1 шт. (при необходимости);
- руководство по эксплуатации.

5. LASER-PROF МД 1 1760/SS, в составе:

**Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения**

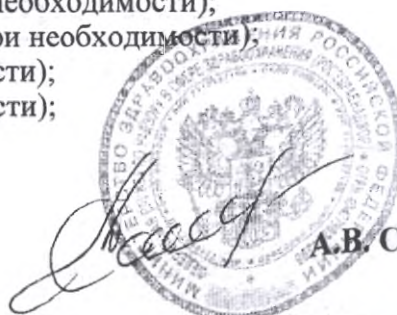

А.В. Самойлова

0086530

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 08 июня 2021 года

№ РЗН 2021/14526

Лист 2

- корпус шкафа - 1 шт.;
 - дверца шкафа стальная - не более 2 шт. (при необходимости);
 - полка шкафа стальная - не более 4 шт. (при необходимости);
 - ручка шкафа - не более 2 шт. (при необходимости);
 - замок шкафа - не более 2 шт. (при необходимости);
 - руководство по эксплуатации.
6. LASER-PROF МД 1 1760/SG, в составе:
- корпус шкафа - 1 шт.;
 - дверца шкафа стальная - не более 2 шт. (при необходимости);
 - дверца шкафа стеклянная - не более 2 шт. (при необходимости);
 - полка шкафа стальная - не более 4 шт. (при необходимости);
 - полка шкафа стеклянная - не более 4 шт. (при необходимости);
 - комплект петель для стекла - не более 2 шт. (при необходимости);
 - ручка шкафа - не более 1 шт. (при необходимости);
 - замок шкафа - не более 1 шт. (при необходимости);
 - руководство по эксплуатации.
7. LASER-PROF МД 1 1760 R, в составе:
- корпус шкафа - 1 шт.;
 - дверца шкафа стальная - не более 2 шт. (при необходимости);
 - дверца шкафа стеклянная - не более 2 шт. (при необходимости);
 - полка шкафа стальная - не более 4 шт. (при необходимости);
 - полка шкафа стеклянная - не более 4 шт. (при необходимости);
 - ручка шкафа - не более 1 шт. (при необходимости);
 - замок шкафа - не более 2 шт. (при необходимости);
 - руководство по эксплуатации.
8. LASER-PROF МД 1 1760 R-1, в составе:
- корпус шкафа - 1 шт.;
 - дверца шкафа стальная - не более 2 шт. (при необходимости);
 - дверца шкафа стеклянная - не более 2 шт. (при необходимости);
 - полка шкафа стальная - не более 4 шт. (при необходимости);
 - полка шкафа стеклянная - не более 4 шт. (при необходимости);
 - ручка шкафа - не более 3 шт. (при необходимости);
 - ящик шкафа - не более 1 шт. (при необходимости);
 - замок шкафа - не более 2 шт. (при необходимости);
 - руководство по эксплуатации.
9. LASER-PROF МД 1 1650 T, в составе:
- корпус шкафа - 1 шт.;
 - дверца шкафа стальная - не более 1 шт. (при необходимости);

**Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения**



А.В. Самойлова

0086531

ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ

от 08 июня 2021 года

№ РЗН 2021/14526

Лист 3

- замок шкафа - не более 1 шт. (при необходимости);

- руководство по эксплуатации.

10. LASER-PROF МД 2 1670/SS, в составе:

- корпус шкафа - 1 шт.;

- дверца шкафа стальная - не более 4 шт. (при необходимости);

- полка шкафа стальная - не более 4 шт. (при необходимости);

- ручка шкафа - не более 4 шт. (при необходимости);

- замок шкафа - не более 2 шт. (при необходимости);

- руководство по эксплуатации.

11. LASER-PROF МД 2 1670/SG, в составе:

- корпус шкафа - 1 шт.;

- дверца шкафа стальная - не более 4 шт. (при необходимости);

- дверца шкафа стеклянная - не более 4 шт. (при необходимости);

- полка шкафа стальная - не более 4 шт. (при необходимости);

- полка шкафа стеклянная - не более 4 шт. (при необходимости);

- комплект петель для стекла - не более 4 шт. (при необходимости);

- ручка шкафа - не более 2 шт. (при необходимости);

- замок шкафа - не более 1 шт. (при необходимости);

- руководство по эксплуатации.

12. LASER-PROF МД 2 1780/SS, в составе:

- корпус шкафа - 1 шт.;

- дверца шкафа стальная - не более 4 шт. (при необходимости);

- полка шкафа стальная - не более 4 шт. (при необходимости);

- ручка шкафа - не более 4 шт. (при необходимости);

- замок шкафа - не более 2 шт. (при необходимости);

- руководство по эксплуатации.

13. LASER-PROF МД 2 1780/SG, в составе:

- корпус шкафа - 1 шт.;

- дверца шкафа стальная - не более 4 шт. (при необходимости);

- дверца шкафа стеклянная - не более 4 шт. (при необходимости);

- полка шкафа стальная - не более 4 шт. (при необходимости);

- полка шкафа стеклянная - не более 4 шт. (при необходимости);

- комплект петель для стекла - не более 4 шт. (при необходимости);

- ручка шкафа - не более 2 шт. (при необходимости);


- замок шкафа - не более 1 шт. (при необходимости);

- руководство по эксплуатации.

14. LASER-PROF МД 2 1780 R, в составе:

- корпус шкафа - 1 шт.;

**Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения**

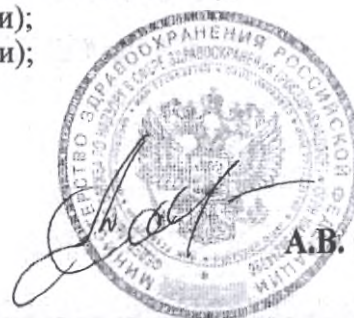

А.В. Самойлова

0086519

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 08 июня 2021 года

№ РЗН 2021/14526

Лист 4

- дверца шкафа стальная - не более 4 шт. (при необходимости);
- дверца шкафа стеклянная - не более 4 шт. (при необходимости);
- полка шкафа стальная - не более 4 шт. (при необходимости);
- полка шкафа стеклянная - не более 4 шт. (при необходимости);
- ручка шкафа - не более 4 шт. (при необходимости);
- замок шкафа - не более 2 шт. (при необходимости);
- руководство по эксплуатации.

15. LASER-PROF МД 2 1780 R-1, в составе:

- корпус шкафа - 1 шт.;
- дверца шкафа стальная - не более 4 шт. (при необходимости);
- дверца шкафа стеклянная - не более 4 шт. (при необходимости);
- полка шкафа стальная - не более 4 шт. (при необходимости);
- полка шкафа стеклянная - не более 4 шт. (при необходимости);
- ручка шкафа - не более 6 шт. (при необходимости);
- ящик шкафа - не более 2 шт. (при необходимости);
- замок шкафа - не более 2 шт. (при необходимости);
- руководство по эксплуатации.

16. LASER-PROF МД 2 1780 R-5, в составе:

- корпус шкафа - 1 шт.;
- дверца шкафа стальная - не более 3 шт. (при необходимости);
- дверца шкафа стеклянная - не более 3 шт. (при необходимости);
- полка шкафа стальная - не более 4 шт. (при необходимости);
- полка шкафа стеклянная - не более 4 шт. (при необходимости);
- ручка шкафа - не более 8 шт. (при необходимости);
- ящик шкафа - не более 5 шт. (при необходимости);
- замок шкафа - не более 2 шт. (при необходимости);
- руководство по эксплуатации.

17. LASER-PROF МД 2 1670 T, в составе:

- корпус шкафа - 1 шт.;
- дверца шкафа стальная - не более 2 шт. (при необходимости);
- замок шкафа - не более 1 шт. (при необходимости);
- руководство по эксплуатации.

18. LASER-PROF МД 1 ПИМ-SS (11-50), в составе:

- корпус шкафа - 1 шт.;
- дверца шкафа стальная - не более 1 шт. (при необходимости);
- полка шкафа стальная - не более 3 шт. (при необходимости);
- замок шкафа - не более 1 шт. (при необходимости);
- руководство по эксплуатации.

**Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения**



А.В. Самойлова

0086520

ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ

от 08 июня 2021 года

№ РЗН 2021/14526

Лист 5

19. LASER-PROF МД 2 ШИМ-SS (21-50), в составе:

- корпус шкафа - 1 шт.;
- дверца шкафа стальная - не более 2 шт. (при необходимости);
- полка шкафа стальная - не более 2 шт. (при необходимости);
- замок шкафа - не более 2 шт. (при необходимости);
- руководство по эксплуатации.

20. LASER-PROF МД LS(LE)-21, в составе:

- корпус шкафа - 1 шт.;
- дверца стальная - не более 2 шт. (при необходимости);
- полка шкафа стальная - не более 2 шт. (при необходимости);
- замок шкафа - не более 2 шт. (при необходимости);
- руководство по эксплуатации.

21. LASER-PROF МД LS(LE)-31, в составе:

- корпус шкафа - 1 шт.;
- дверца шкафа стальная - не более 3 шт. (при необходимости);
- полка шкафа стальная - не более 3 шт. (при необходимости);
- замок шкафа - не более 3 шт. (при необходимости);
- руководство по эксплуатации.

22. LASER-PROF МД LS(LE)-41, в составе:

- корпус шкафа - 1 шт.;
- дверца шкафа стальная - не более 4 шт. (при необходимости);
- полка шкафа стальная - не более 4 шт. (при необходимости);
- замок шкафа - не более 4 шт. (при необходимости);
- руководство по эксплуатации.

23. LASER-PROF МД LS(LE)-21-60 U, в составе:

- корпус шкафа - 1 шт.;
- дверца шкафа стальная - не более 2 шт. (при необходимости);
- полка шкафа стальная - не более 3 шт. (при необходимости);
- замок шкафа - не более 2 шт. (при необходимости);
- руководство по эксплуатации.

24. LASER-PROF МД LS(LE)-21-80, в составе:

- корпус шкафа - 1 шт.;
- дверца шкафа стальная - не более 2 шт. (при необходимости);
- полка шкафа стальная - не более 2 шт. (при необходимости);
- замок шкафа - не более 2 шт. (при необходимости);
- руководство по эксплуатации.

25. LASER-PROF МД LS(LE)-21-80 U, в составе:

- корпус шкафа - 1 шт.;

Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения



А.В. Самойлова

0086521

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 08 июня 2021 года

№ РЗН 2021/14526

Лист 6

- дверца шкафа стальная - не более 2 шт. (при необходимости);
- полка шкафа стальная - не более 3 шт. (при необходимости);
- замок шкафа - не более 2 шт. (при необходимости);
- руководство по эксплуатации.

26. LASER-PROF МД СВ-12, в составе:

- корпус шкафа - 1 шт.;
- дверца шкафа стальная - не более 2 шт. (при необходимости);
- полка шкафа стальная - не более 4 шт. (при необходимости);
- замок шкафа - не более 1 шт. (при необходимости);
- руководство по эксплуатации.

27. LASER-PROF МД СВ-14, в составе:

- корпус шкафа - 1 шт.;
- дверца шкафа стальная - не более 2 шт. (при необходимости);
- полка шкафа стальная - не более 4 шт. (при необходимости);
- замок шкафа - не более 1 шт. (при необходимости);
- руководство по эксплуатации.

28. LASER-PROF МД М-18, в составе:

- корпус шкафа - 1 шт.;
- дверца шкафа стальная - не более 2 шт. (при необходимости);
- полка шкафа стальная - не более 4 шт. (при необходимости);
- замок шкафа - не более 1 шт. (при необходимости);
- руководство по эксплуатации.

29. LASER-PROF МД АМ-1845, в составе:

- корпус шкафа - 1 шт.;
- дверца шкафа стальная - не более 1 шт. (при необходимости);
- полка шкафа стальная - не более 4 шт. (при необходимости);
- замок шкафа - не более 1 шт. (при необходимости);
- руководство по эксплуатации.

30. LASER-PROF МД АМ-1845/4, в составе:

- корпус шкафа - 1 шт.;
- дверца шкафа стальная - не более 4 шт. (при необходимости);
- замок шкафа - не более 4 шт. (при необходимости);
- руководство по эксплуатации.

31. LASER-PROF МД АМ 1891, в составе:

- корпус шкафа - 1 шт.;
- дверца шкафа стальная - не более 2 шт. (при необходимости);
- полка шкафа стальная - не более 4 шт. (при необходимости);
- замок шкафа - не более 1 шт. (при необходимости);

**Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения**



А.В. Самойлова

0086522

ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ

от 08 июня 2021 года

№ РЗН 2021/14526

Лист 7

- руководство по эксплуатации.

32. LASER-PROF МД АМ-2091, в составе:

- корпус шкафа - 1 шт.;
- дверца шкафа стальная - не более 2 шт. (при необходимости);
- полка шкафа стальная - не более 4 шт. (при необходимости);
- замок шкафа - не более 1 шт. (при необходимости);
- руководство по эксплуатации.

33. LASER-PROF AMD-39, в составе:

- корпус шкафа - 1 шт.;
- дверца шкафа стальная - не более 1 шт. (при необходимости);
- полка шкафа стальная - не более 2 шт. (при необходимости);
- замок шкафа - не более 1 шт. (при необходимости);
- руководство по эксплуатации.

34. LASER-PROF AMD-39G, в составе:

- корпус шкафа - 1 шт.;
- дверца шкафа стальная - не более 1 шт. (при необходимости);
- дверца шкафа стеклянная - не более 1 шт. (при необходимости);
- полка шкафа стальная - не более 2 шт. (при необходимости);
- комплект петель для стекла - не более 1 шт. (при необходимости);
- замок шкафа - не более 1 шт. (при необходимости);
- руководство по эксплуатации.

35. LASER-PROF AMD-40, в составе:

- корпус шкафа - 1 шт.;
- дверца шкафа стальная - не более 1 шт. (при необходимости);
- полка шкафа стальная - не более 2 шт. (при необходимости);
- замок шкафа - не более 1 шт. (при необходимости);
- руководство по эксплуатации.

36. LASER-PROF МД А 42, в составе:


- корпус шкафа - 1 шт.;
- ящик шкафа - не более 2 шт. (при необходимости);
- замок шкафа - не более 1 шт. (при необходимости);
- руководство по эксплуатации.

37. LASER-PROF МД А 43, в составе:

- корпус шкафа - 1 шт.;
- ящик шкафа - не более 3 шт. (при необходимости);
- замок шкафа - не более 1 шт. (при необходимости);
- руководство по эксплуатации.

38. LASER-PROF МД А 44, в составе:

**Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения**

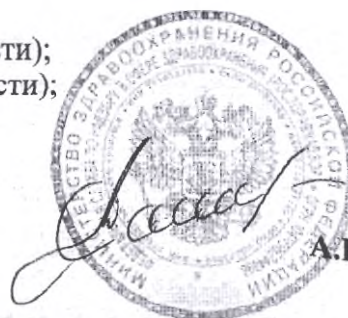

А.В. Самойлова

0086532

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 08 июня 2021 года

№ РЗН 2021/14526

Лист 8

- корпус шкафа - 1 шт.;
- ящик шкафа - не более 4 шт. (при необходимости);
- замок шкафа - не более 1 шт. (при необходимости);
- руководство по эксплуатации.

39. LASER-PROF МД AFC-04, в составе:

- корпус шкафа - 1 шт.;
- ящик шкафа - не более 4 шт. (при необходимости);
- замок шкафа - не более 1 шт. (при необходимости);
- руководство по эксплуатации.

40. LASER-PROF МД AFC-05, в составе:

- корпус шкафа - 1 шт.;
- ящик шкафа - не более 5 шт. (при необходимости);
- замок шкафа - не более 1 шт. (при необходимости);
- руководство по эксплуатации.

41. LASER-PROF МД AFC-06, в составе:

- корпус шкафа - 1 шт.;
- ящик шкафа - не более 6 шт. (при необходимости);
- замок шкафа - не более 1 шт. (при необходимости);
- руководство по эксплуатации.

42. LASER-PROF МД AFC-07, в составе:

- корпус шкафа - 1 шт.;
- ящик шкафа - не более 7 шт. (при необходимости);
- замок шкафа - не более 1 шт. (при необходимости);
- руководство по эксплуатации.

43. LASER-PROF МД AFC-09C, в составе:

- корпус шкафа - 1 шт.;
- ящик шкафа - не более 9 шт. (при необходимости);
- замок шкафа - не более 1 шт. (при необходимости);
- руководство по эксплуатации.

2

Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения



А.В. Самойлова

0086524